

Kopfschutz-Versorgung

Die Kopfmaße bestimmen Sie, indem Sie ein flexibles Maßband (schmales Schneiderband) gemäß den unten abgebildeten Skizzen benutzen.

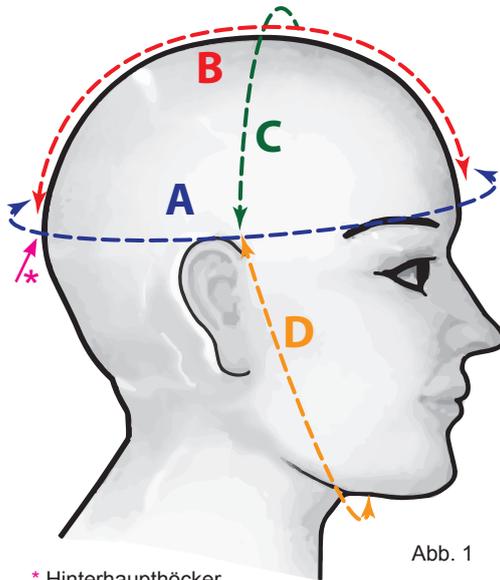


Abb. 1

* Hinterhauptöcker

1

- A..... cm (Kopfumfang Augenbrauenhöhe – über den Hinterhauptöcker)
- B..... cm (Mitte zwischen Augenbrauen bis Hinterhauptöcker)
- C..... cm (Über den Kopf von Ohr zu Ohr)
- D..... cm

SH/Fachhandel:

Burbach+Goetz
Deutsche Sanitätshaus GmbH



Ansprechpartner:

Patient/in:

Krankheitsbild:

2

Auszufüllen, wenn Starlight Protect, Starlight Protect Plus oder Starlight Go-Sport, Starlight Go-Sport Plus benötigt wird.

- E..... cm
- F..... cm


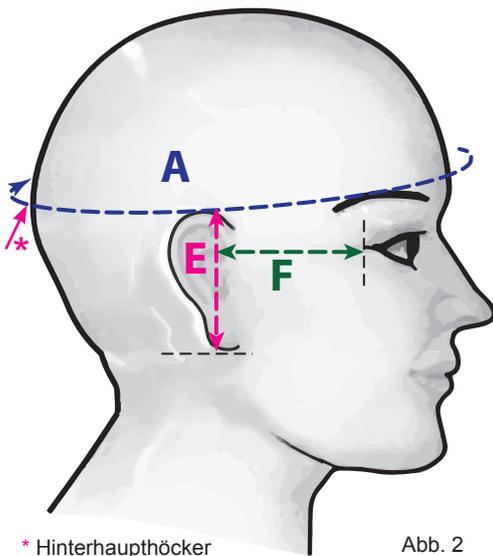


Abb. 2

* Hinterhauptöcker

Schädelperspektiven

Abb. 4

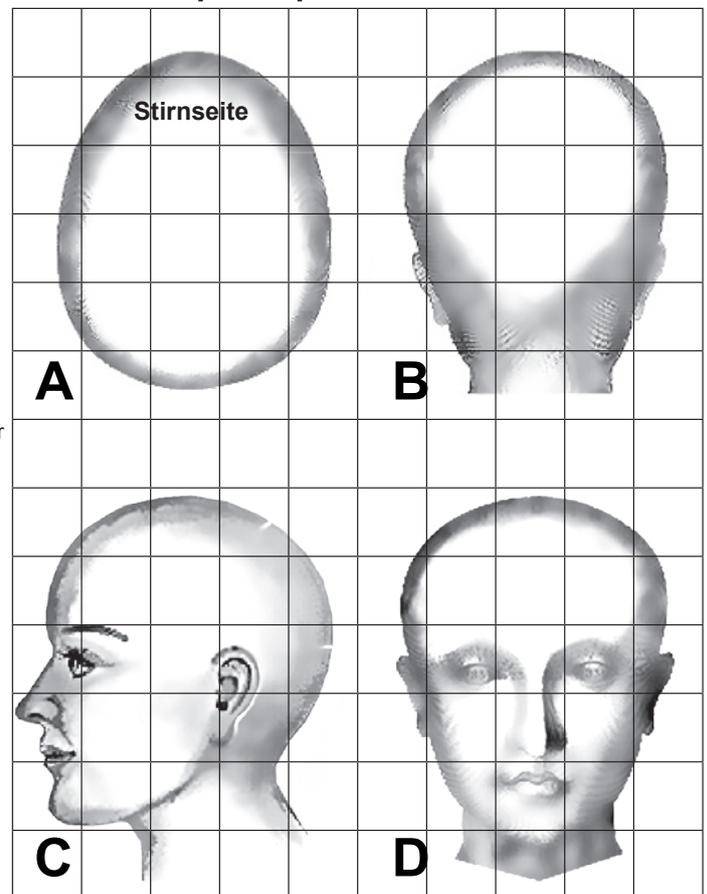

Bitte korrigieren Sie bei Bedarf in den oberen Zeichnungen die Stirn und/oder Schädelform, bzw. tragen Sie eventuelle sonstige Abweichungen ein.

3

Auszufüllen, wenn Starlight Protect, Starlight Protect Plus oder Starlight Go-Sport, Starlight Go-Sport Plus benötigt wird.

- G..... cm
- H..... cm



Abb. 3

Bemerkungen